取扱説明書

CONDOR Trust of the Quality

床置き式手すり「楽起」用 楽どめ

（介助バー型）

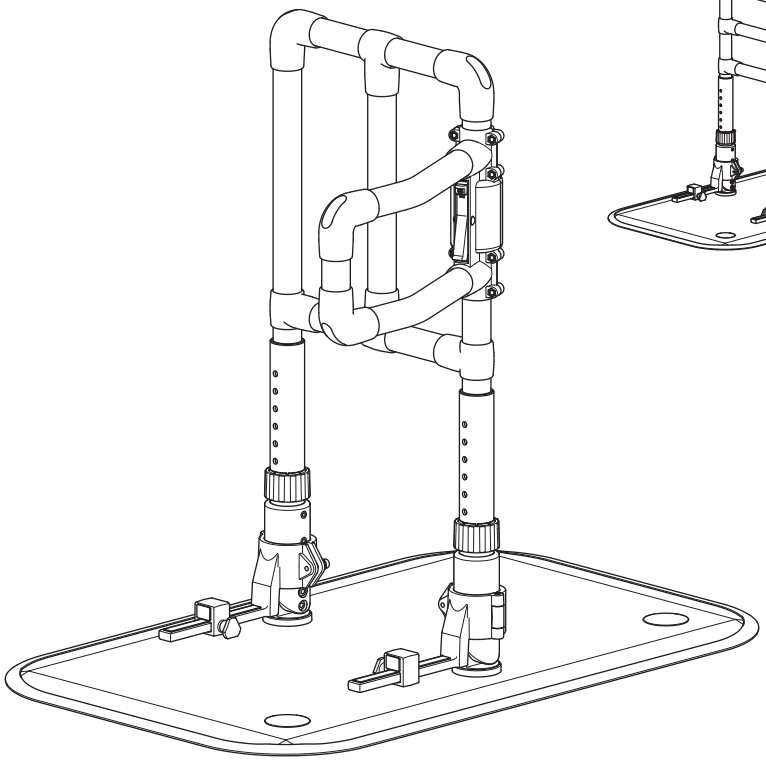

（横型）

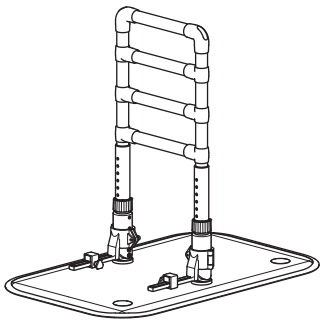

（縦型）

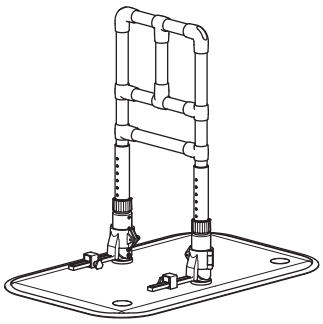

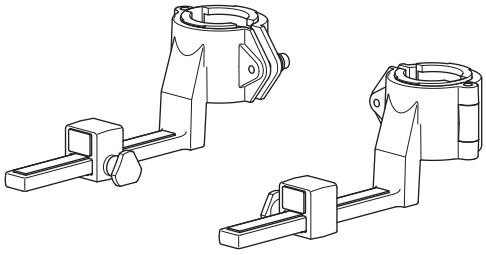

目次

⚠ 安全に関するご注意 ・・・・・・・P1
1. 設置上のご注意 ・・・・・・・・・P2
2. 使用上のご注意 ・・・・・・・・・P2
3. 各部名称および梱包内容 ・・・・P3
4. 取り付けの前に ・・・・・・・・・P3-4
5. 「楽起」への取り付け方法 ・・・・P4
6. ベッドへの取り付け方法 ・・・・・P5
7. お手入れ方法 ・・・・・・・・・・P5

安全に関するご注意

このたびは、床置き式手すり「楽起」用「楽どめ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
この説明書はお読みになった後もいつでも見れる場所に大切に保管してください。
※床置き式手すり「楽起」の取扱説明書とあわせてご覧ください。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、ご本人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

禁止	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。
必ず実行	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

1.設置上のご注意

⚠警告	禁止	●他社製品と組み合わせて使用しない。 破損や事故の原因になります。また、他社製品と組み合わせた場合の安全性は保証できません。
		●製品の分解、改造は絶対にしない。 破損や事故の原因になります。
	必ず実行	●設置の際は、「楽起」の手すりパイプとベッドサイドフレームの隙間が2～6cmの範囲内で、できるだけ近づけて設置する。手すりとベッドを密着させた状態、または隙間を空けすぎた状態で使用しない。 隙間に頭や腕、脚をはさむなど、事故の原因になります。
		●必ず左右セットで取り付けて使用する。 破損や事故の原因になります。
		●電動ベッドで使用する場合は、電動ベッドの取扱説明書を確認する。 特殊寝台など、本製品が使用できない場合があります。
		●設置後、ガタつき、ボルトのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認する。 破損や事故の原因になります。
		●定期的にガタつき、ボルトのゆるみ、締め忘れ、部品の破損がないことを確認する。
⚠注意	禁止	●屋外や直射日光の当たる場所には設置しない。 本製品は屋内用です。変質や変形、破損の原因になります。 金属部分が熱くなり、火傷の原因になります。
		●火気を近づけたり、ストーブやヒーターのそばには設置しない。 火災や変質、変形、破損の原因になります。 金属部分が熱くなり、火傷の原因になります。
		●浴室や脱衣場、洗面所など、水気のある場所には設置しない。 変質や変形、破損の原因になります。
	必ず実行	●ベッドを移動させる際は、「楽どめ」を外してから移動する。 破損や事故の原因になります。
		●製品の取り付けは納入業者が行う。

2.使用上のご注意

⚠警告	禁止	●「楽起」の安定性向上以外の目的で使用しない。 「楽どめ」は「楽起」をベッドで使用する際の安定性を向上させる製品です。 踏み台など、本来の用途以外の目的で使用しますと事故やケガの原因になります。
	必ず実行	●手すりの水平方向から、引っ張る、押すなど力を加えたり、体をぶつけたりしない。 水平方向から力を加えた場合、「楽起」が移動し、隙間ができる可能性があるので注意してください。 「楽どめ」は、「楽起」の安定性を向上させるものであり、固定するものではありません。
		●製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。 正しく設置できない場合や機能を損なう状態の場合は直ちにご使用を中止し、納入業者にご連絡ください。
⚠注意	禁止	●殺虫剤などのスプレーを本製品に向けて噴射しない。 変質や変形、破損の原因になります。
		●昇降機能のある電動ベッドでは使用しない。 破損や事故の原因になります。
	必ず実行	●床面とベッドのサイドフレーム下端との間に、35～350mmの隙間があるか確認する。 隙間がない場合、製品を正しく取り付けることができず、破損や事故の原因になります。
		●ボルトやノブなどの突起に、衣服などを引っ掛けないように注意する。 移乗の際に転倒するおそれがあります。
		●可動部に手や衣服などをはさまないよう注意する。
		●お手入れの際は、取扱説明書に記載のお手入れ方法を確認する。 記載方法以外でお手入れを行った場合、変質や変形、破損のおそれがあります。

3.各部名称および梱包内容

記載部品が全て揃っているか、また破損や変形などしていないか確認してください。
万が一、部品の不足や破損があった場合は、納入業者にご連絡ください。

＜各部名称＞

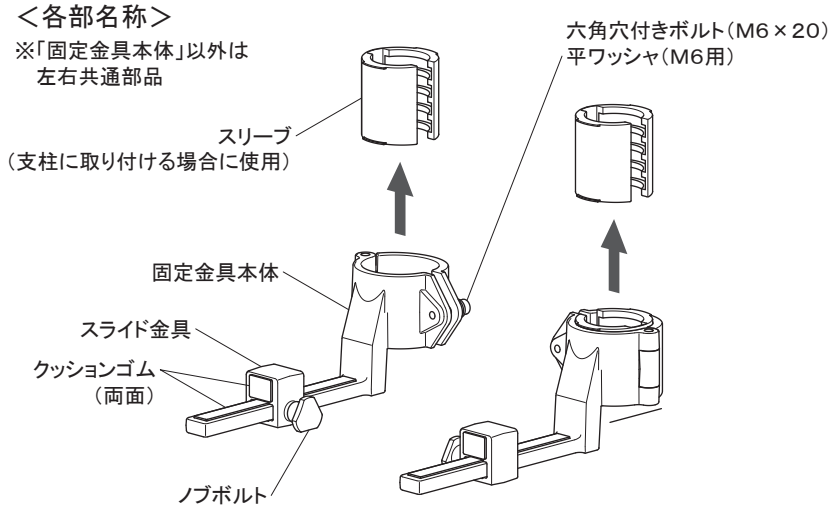

＜梱包内容＞

固定金具（左）×1　固定金具（右）×1

取扱説明書（本紙）×1

※六角穴付きボルト（M6×20）の締め付け・取り外しには、「楽起」付属の「六角棒スパナ（呼び5）」をご使用ください。

4.取り付けの前に

●取り付けは、納入業者の方が行なうようお願いいたします。
●床面とベッドのサイドフレーム下端との間隔が35mm～350mmのベッドに対応できます。（図1）
●ベッドのサイドフレーム裏側にスライド金具を取り付けられる空間がない場合は、スライド金具を取り外してご使用ください。その場合、若干、安定性は低下しますが、「楽どめ」を使用しない場合に比べると、「楽起」のグラつきの軽減や、転倒防止といった効果があります。（図2）

図1

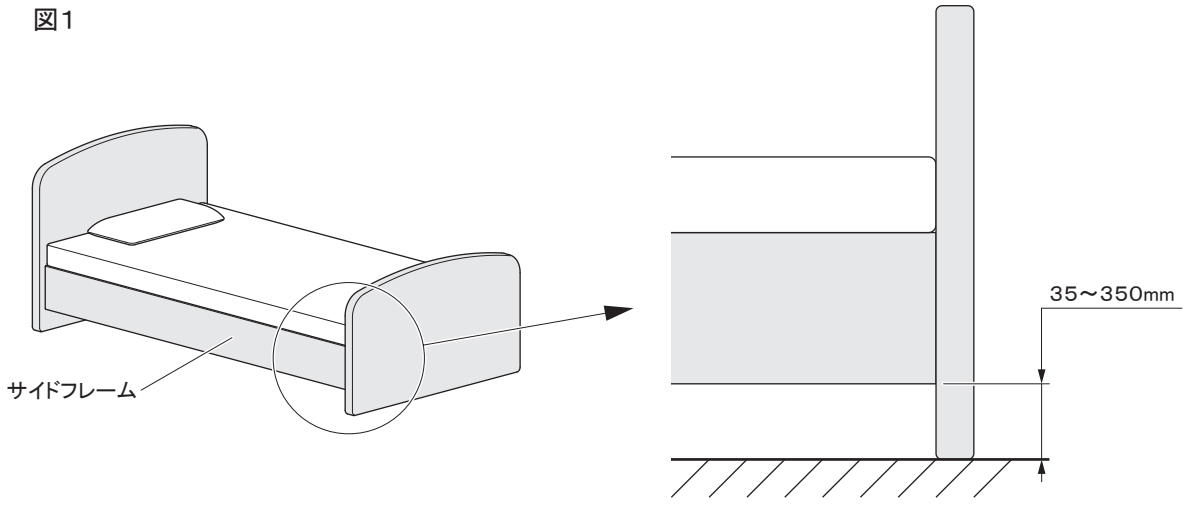

図2

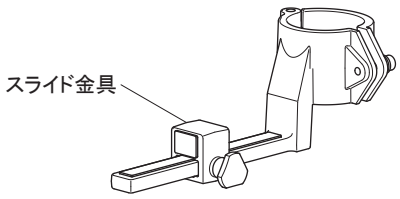

スライド金具が取付可能な場合

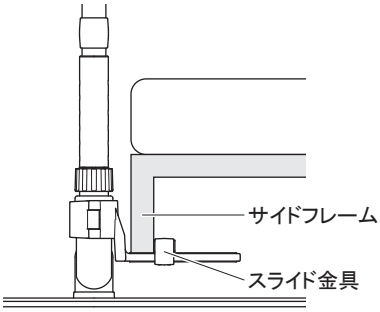

スライド金具が取付不可能な場合

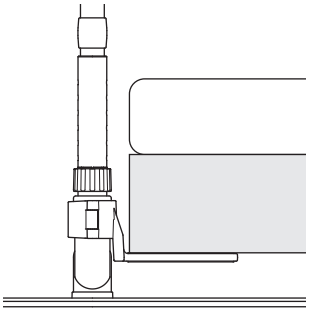

●床面からベッドのサイドフレーム下端までの間隔が広い場合や、「楽どめ」とストッパー用キャップが干渉して最適な高さに調整できない場合などは、「楽どめ」の上下を逆にして取り付けてください。（図1）（図2）
※この際、（図3）を参考に、スライド金具の上下の向きを付け替えてください。
「楽起」に取り付ける際は、ボルト取付側とノブボルトが内側を向くように取り付けでください。

図1

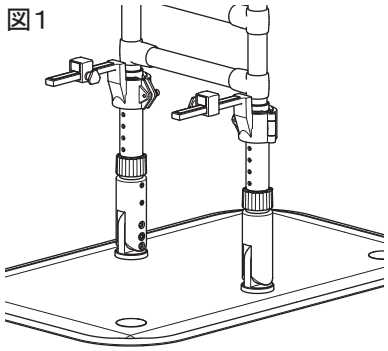

図2

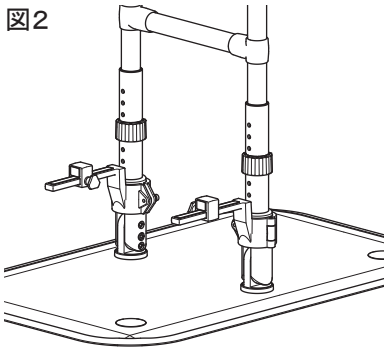

図3

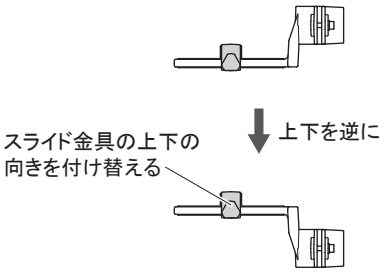

5.「楽起」への取り付け方法

※「楽起」に付属の六角棒スパナ（呼び5）をご用意ください。

5−1.「楽起」の “ヒンジ”に取り付ける場合

1.「楽どめ」から六角穴付きボルト（M6×20）・平ワッシャ（M6用）を取り外します。

2. ボルト取付側とノブボルトが内側を向くように「楽どめ」をヒンジに取り付けます。（図1）

3. ＜手順1＞で取り外したボルト・平ワッシャを取り付けます。（図2）

図1

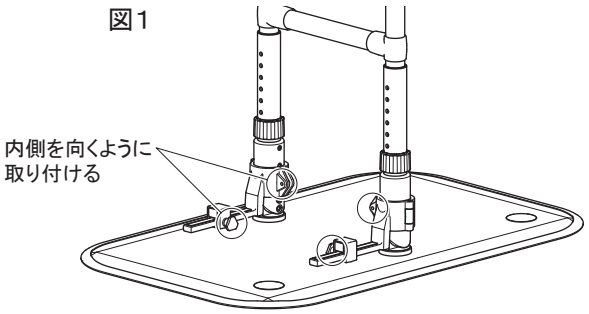

図2

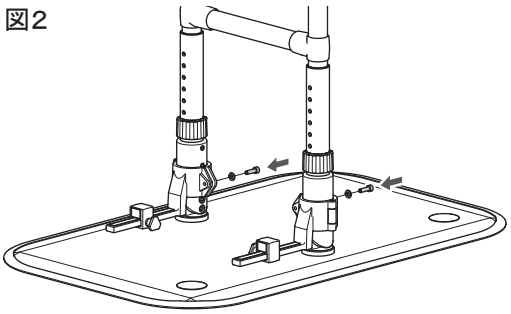

5−2.「楽起」の “支柱”に取り付ける場合

1.「楽どめ」から六角穴付きボルト（M6×20）・平ワッシャ（M6用）を取り外します。

2. ①スリーブ、②固定金具本体の順に支柱に取り付けます。（図3）
ボルト取付側とノブボルトが内側を向くように取り付けてください。

3. ＜手順1＞で取り外したボルト・平ワッシャを取り付けます。（図4）

図3

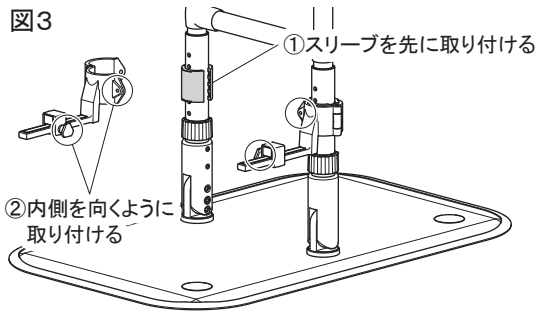

図4

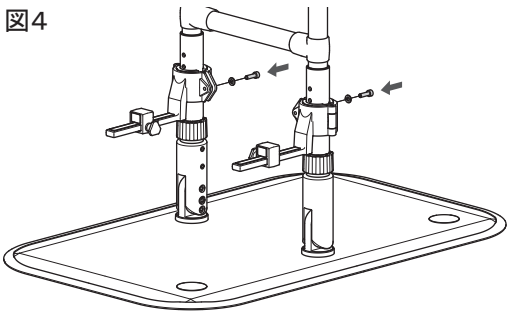

6.ベッドへの取り付け方法

※「楽起」に付属の六角棒スパナ（呼び5）をご用意ください。

1. 「楽起」の手すりパイプとベッドサイドフレームの隙間が2～6cmの範囲内で、できるだけ近づけて設置してください。
「楽起」とベッドのサイドフレームは平行になるように設置してください。

2. 固定金具本体のクッションゴムがベッドのサイドフレームの下端に当たるまでスライドさせます。（図1）
「楽どめ」とベッドのサイドフレームが垂直であることを確認し、六角穴付きボルトをスパナで締め付けます。

3. スライド金具をベッドのサイドフレームの裏側に当たるまでスライドさせ、
ノブボルトを手でしっかりと締め付けます。（図2）

図1

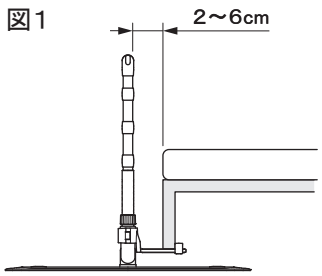

図2

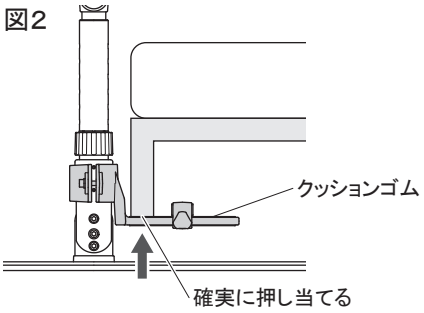

図3

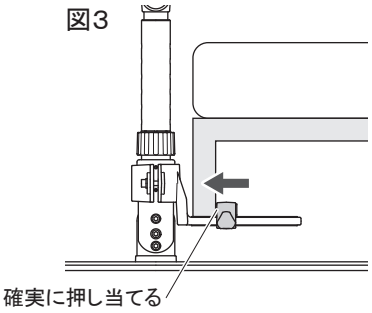

図4（設置完了図）

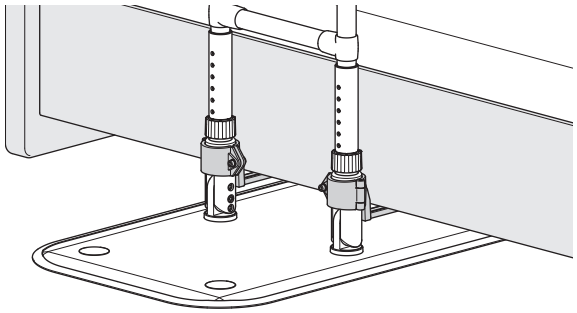

7.お手入れ方法

●金属部分
普段のお手入れ：柔らかい布でから拭きしてください。
汚れた時　　：家具用クリーナーで拭き取ってください。

●樹脂部分
普段のお手入れ：柔らかい布でから拭きしてください。
汚れた時　　：薄めた中性洗剤を染み込ませた布で拭き、仕上げに水拭きしてください。

●消毒方法
アルコールを使用する場合：アルコール消毒剤を柔らかい布に吹きつけてから清拭してください。
次亜塩素酸を使用する場合：6%水溶液を100～200倍に希釈して清拭し、仕上げに水拭きしてください。

⚠注意
〇製品に60℃以上の温度を加えないでください。乾燥室をご使用の際は、室温を60℃以下に設定し、
製品に直接熱風・熱気が当たらないようにしてください。製品の変形や破損の原因になります。
〇汚れ具合により、期待通りの結果が得られない場合もあります。
〇次亜塩素酸を希釈せずに使用したり、希釈溶液に浸漬させての消毒はおやめください。
〇有機溶剤（シンナー・ベンジンなど）、殺虫剤、強酸性洗剤は使用しないでください。
〇オゾンガスは金属部分に影響を与えるため、使用しないでください。
〇金属ブラシ、ナイロンたわしなどは傷をつけるため、使用しないでください。
〇高圧洗浄機や水洗いはしないでください。サビなど劣化させる恐れがあります。
〇オートクレーブには対応しておりません。

※製品の仕様、外観等は、改良などにより、予告なしに変更することがあります。

CONDOR
Trust of the Quality
山崎産業株式会社
第五営業本部　〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目10番12号
TEL　(03)5777-2002
MAIL Info2@yamazaki-sangyo.co.jp
ホームページ　www.yamazaki-sangyo.co.jp

紙

20150803